


CANDY

CA182T..

CA183..


CA303..

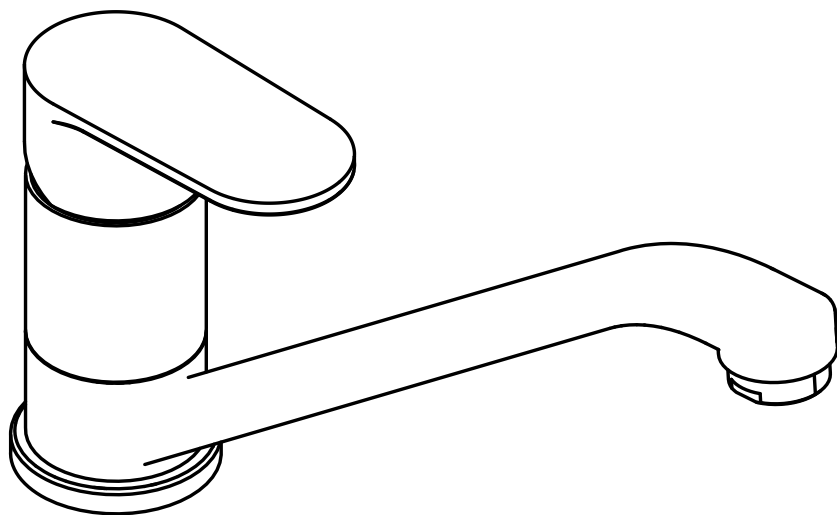

IST012
Rev.2019.02

1


Montaggio Assembly

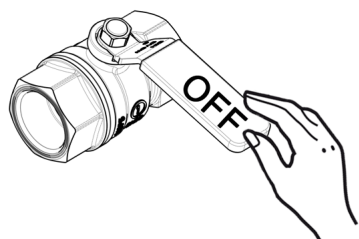

$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX



OK


Fissaggio leva clinica
Fixing clinical lever

303

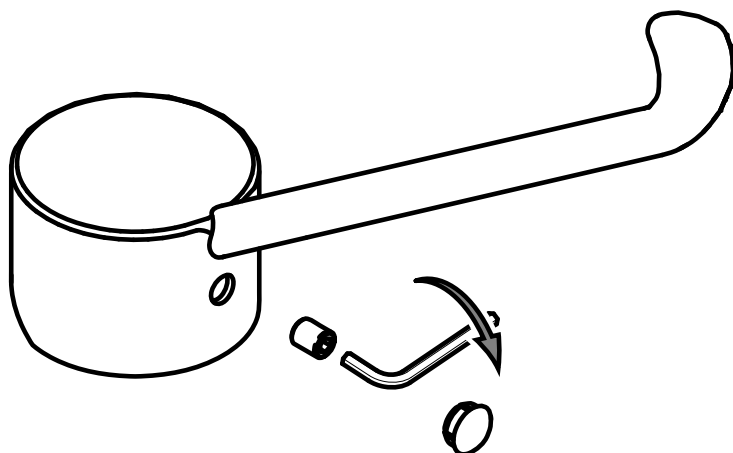

2 a


182T


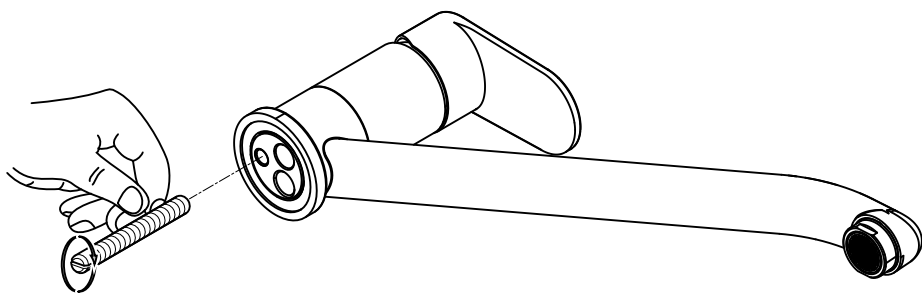


b

 CALDO
HOT



 FREDDO
COLD

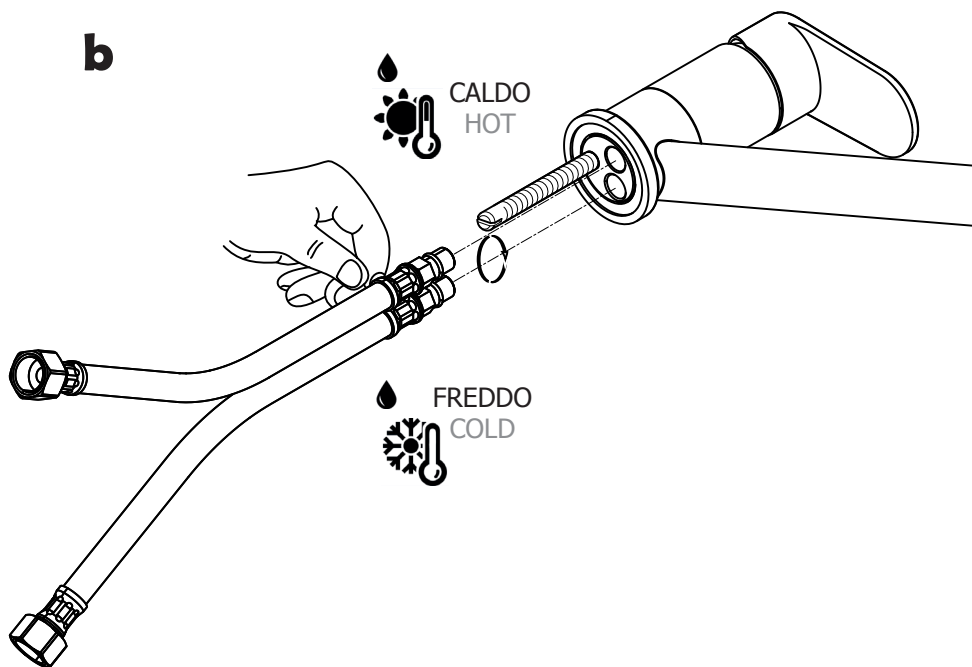


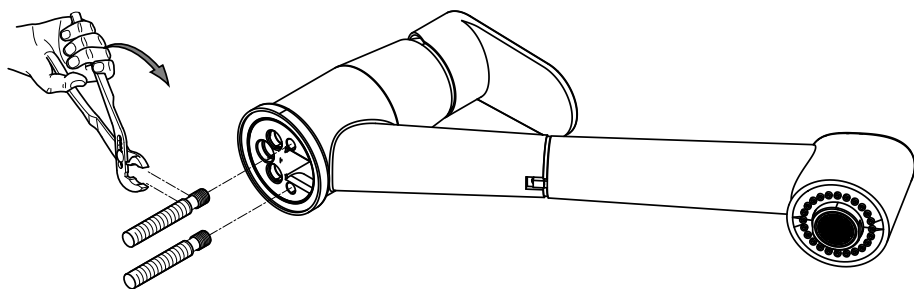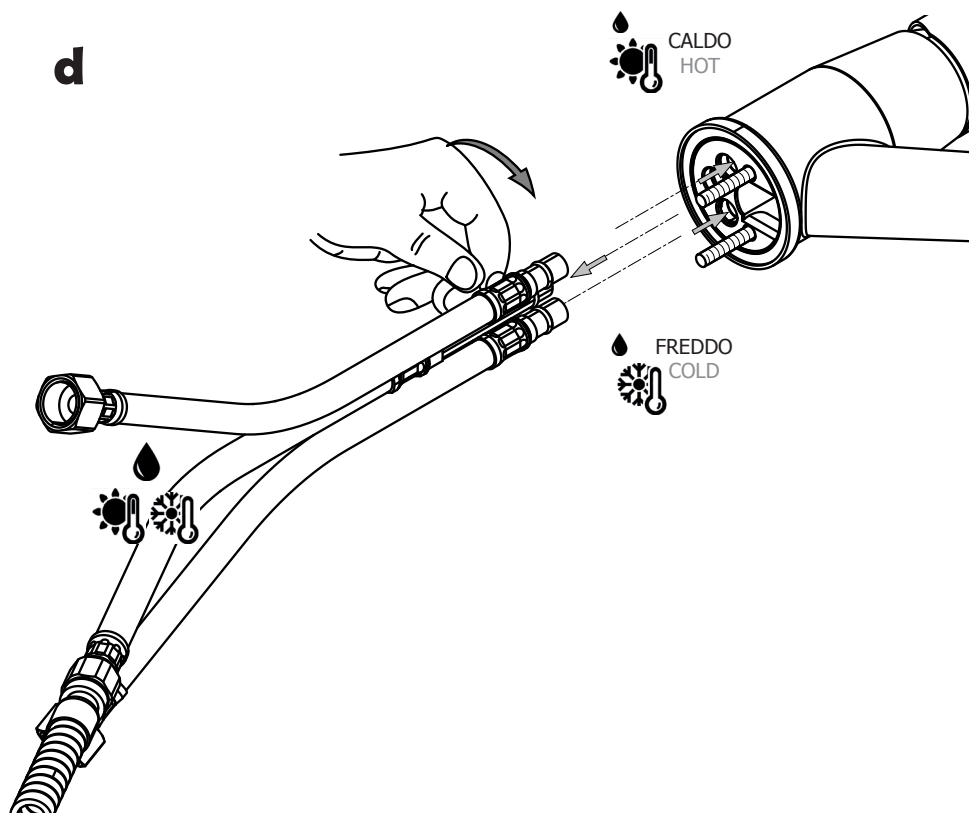c**d**

3


182T
183

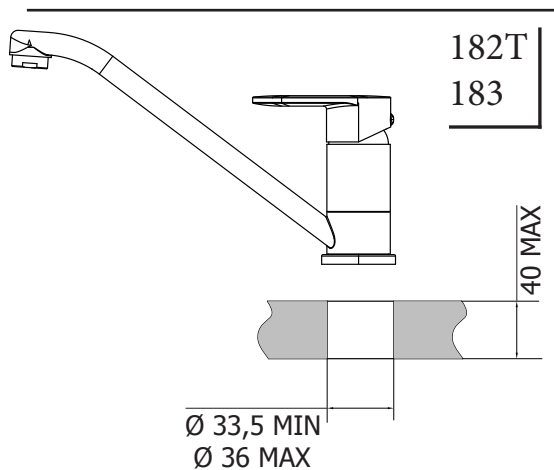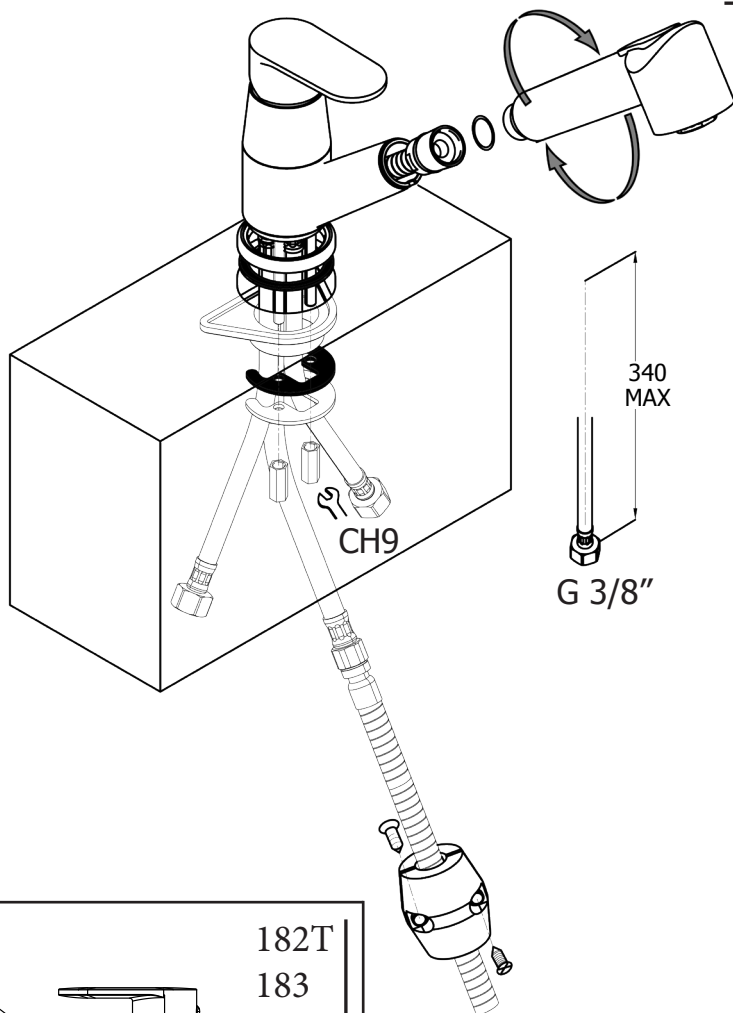

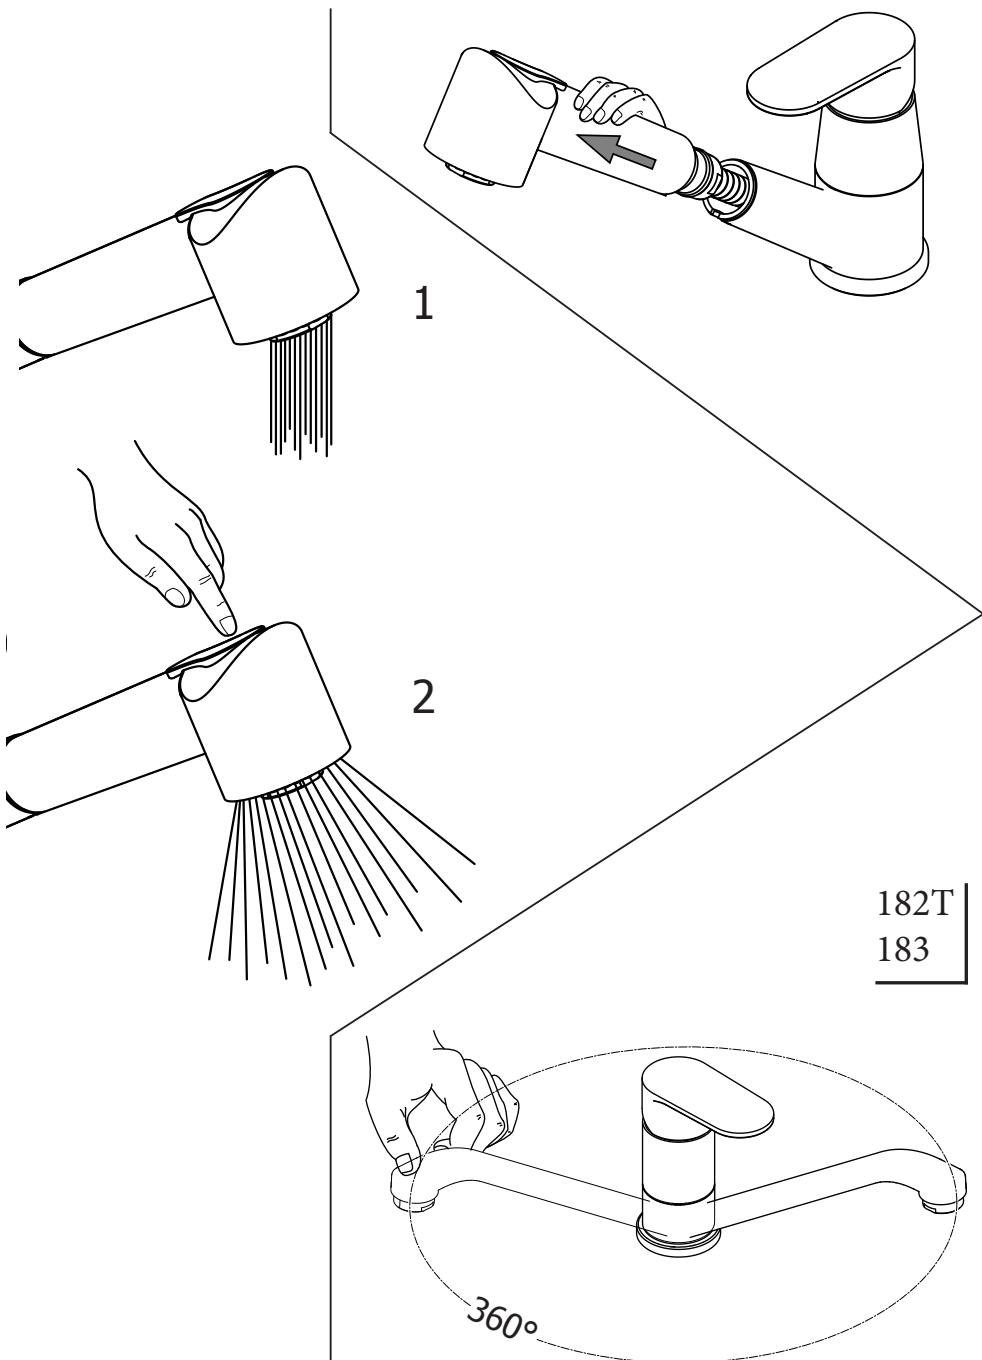

M


Manutenzione Service

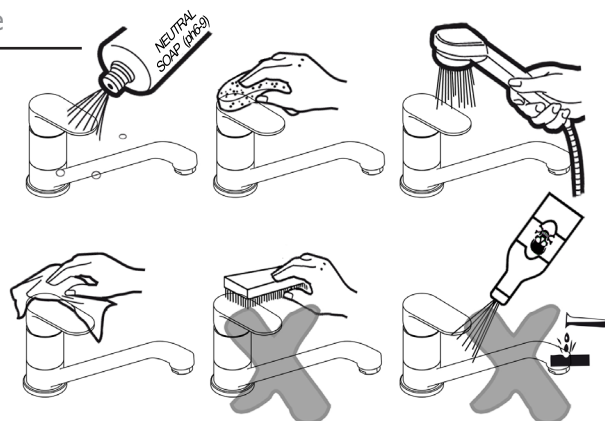

P

Pulizia Cleaning


183

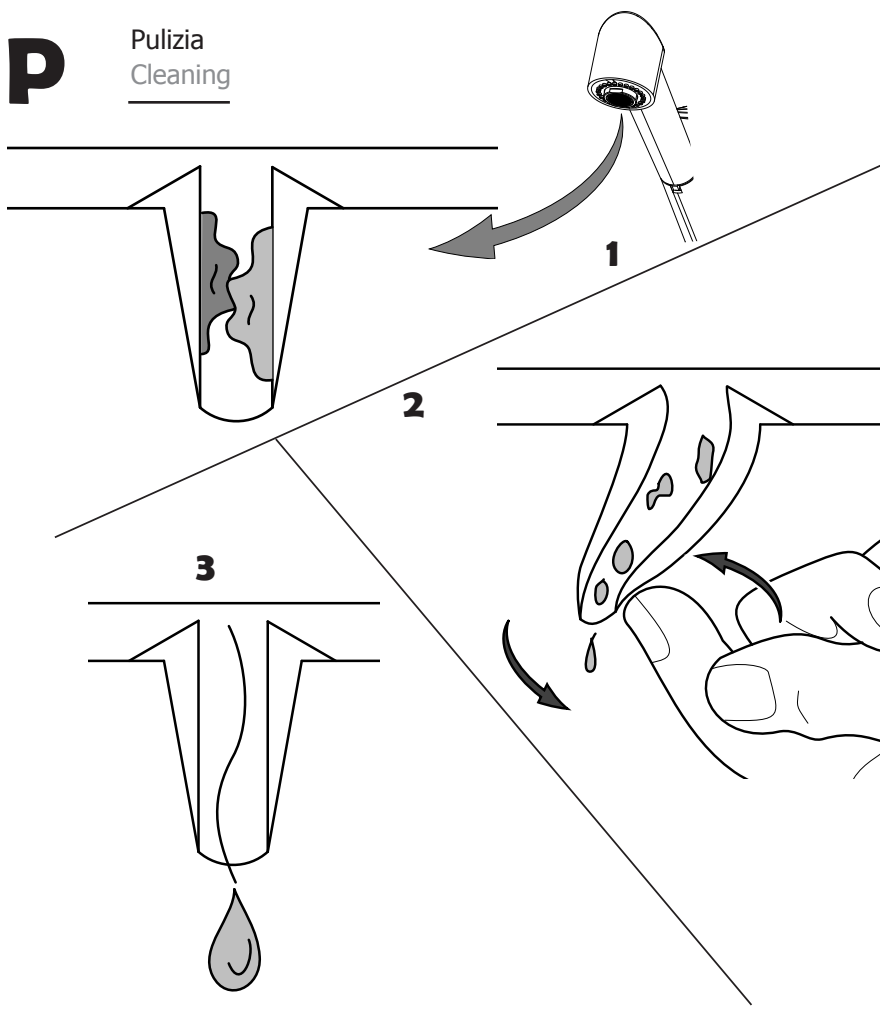

S Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

182T
183

a

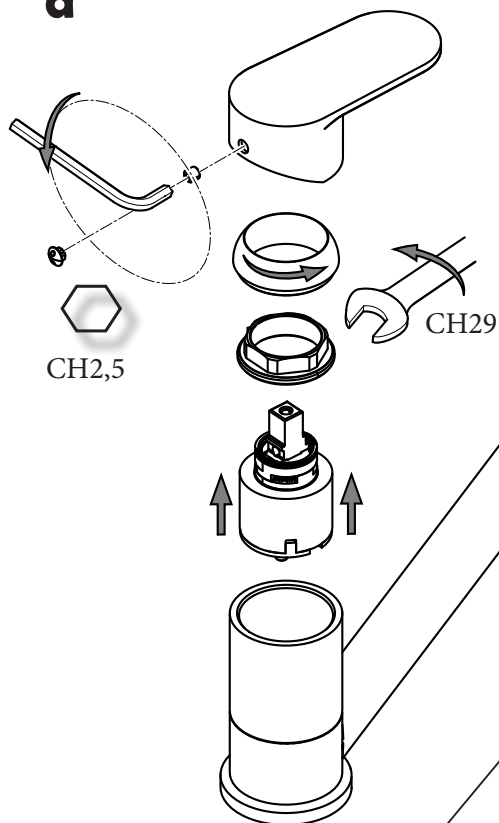

b

Sostituzione Aeratore How to replace Aerator

