

COMPACT BOX

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=modular_service

PROLUNGHE EXTENSION

ZPRO092 per/for Miscelatore/ Mixer
ZPRO093 per/for Termostatico/ Thermostatic

RICAMBI SPARE PARTS

TERMOSTATICI THERMOSTATICS

ZRAC145
ZVIT120
ZSET106..
ZGHI038
ZACC472..
ZMAN207.. ☐
ZMAN209.. ☐
ZSET107
ZDEV112

MISCELATORI MIXERS

ZA91380
ZGHI037
ZSET105
ZSET106..
ZGHI038
ZACC473..
ZMAN208.. ☐
ZMAN210.. ☐
ZSET107
ZDEV112

PIASTRE WALL PLATES

TERMOSTATICI THERMOSTATICS

ZPIA136.. ☐ 1
ZPIA137.. ☐ 2
ZPIA138.. ☐ 3
ZPIA142.. ☐ 1
ZPIA143.. ☐ 2
ZPIA144.. ☐ 3


MISCELATORI MIXERS

ZPIA139.. ☐ 1
ZPIA140.. ☐ 2
ZPIA141.. ☐ 3
ZPIA145.. ☐ 1
ZPIA146.. ☐ 2
ZPIA147.. ☐ 3




PROLUNGHE EXTENSION

ZPRO092




Per miscelatori CPM 013 513
For mixers CPM 018 518
CPM 019 519

ZPRO093




Per termostatici CPT 013 513
For thermostatics CPT 018 518
CPT 019 519




Set prolunga per miscelatori
Extension set for mixers


ZPRO092

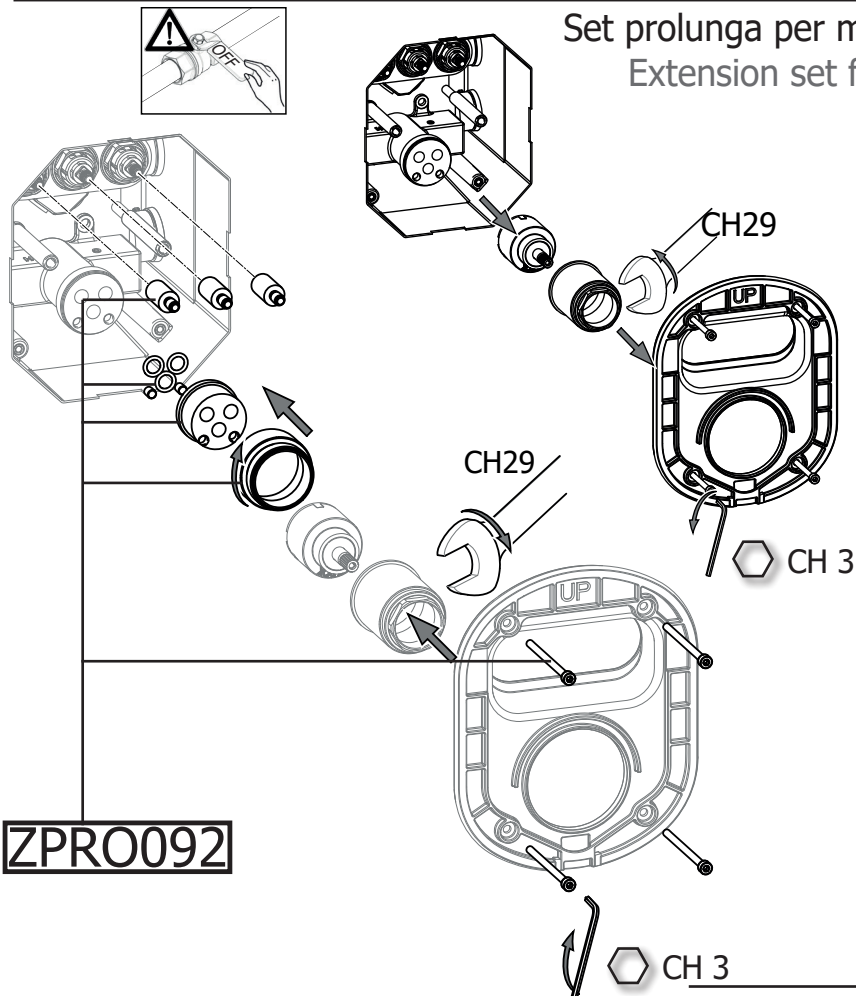


ZPRO092

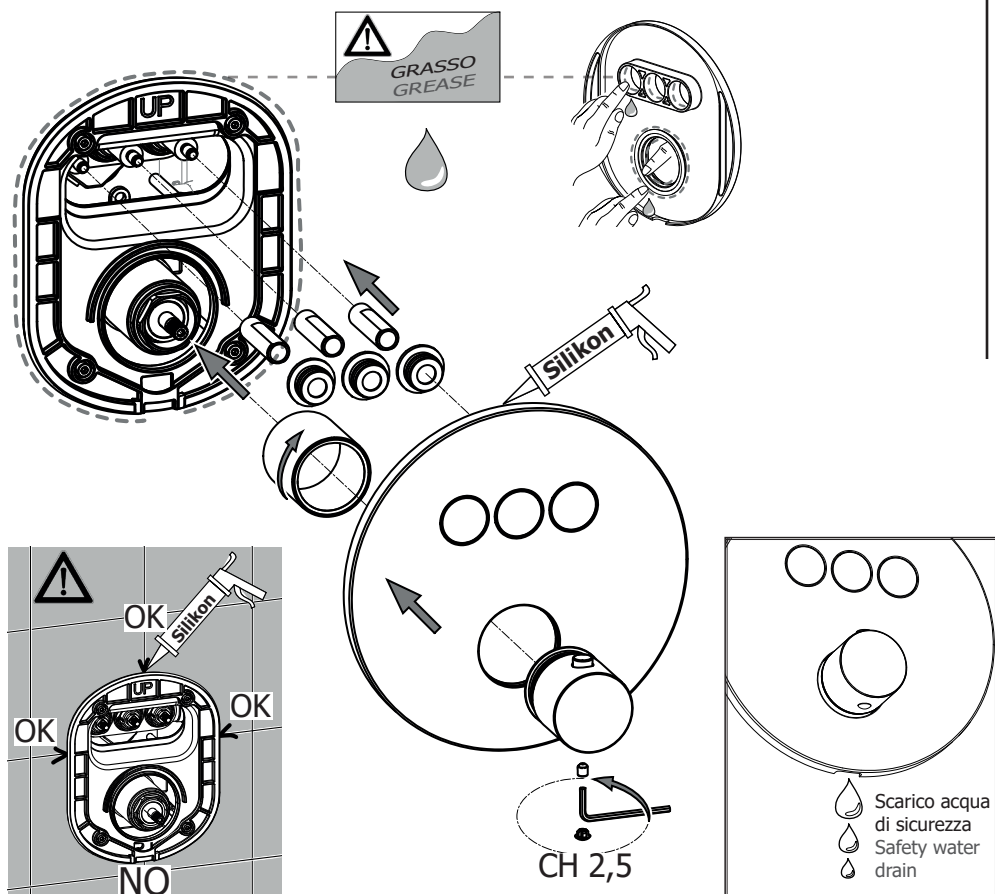

Verifica posizione cartuccia e montaggio maniglia
Cartridge check position and replace Handle

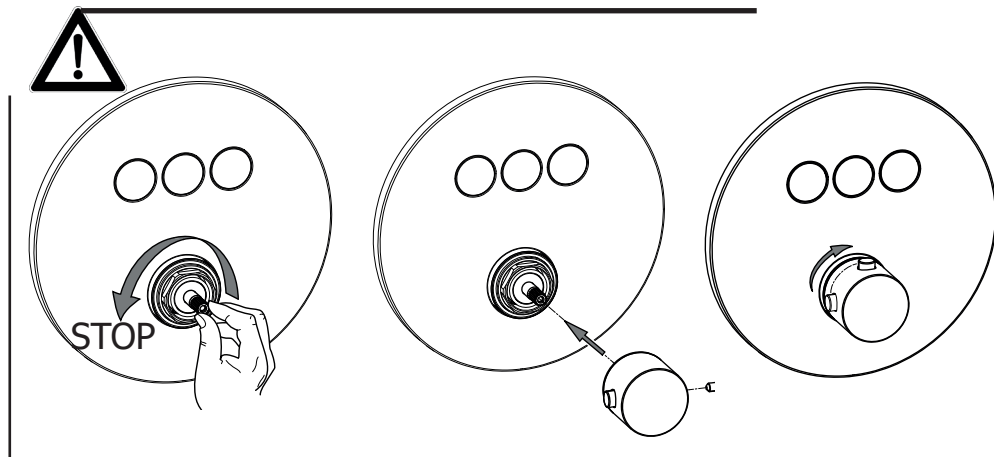


A




Set prolunga per termostatici
Extension set fot thermostatics




ZPRO093

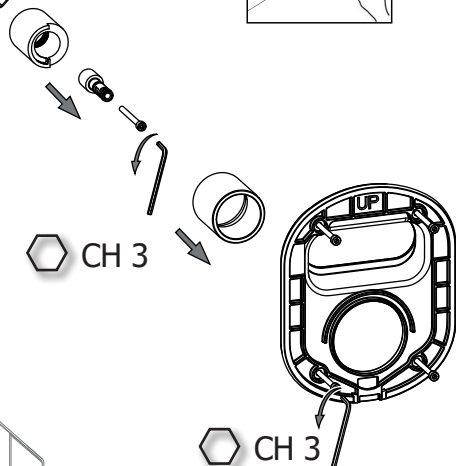


B




ZPRO093

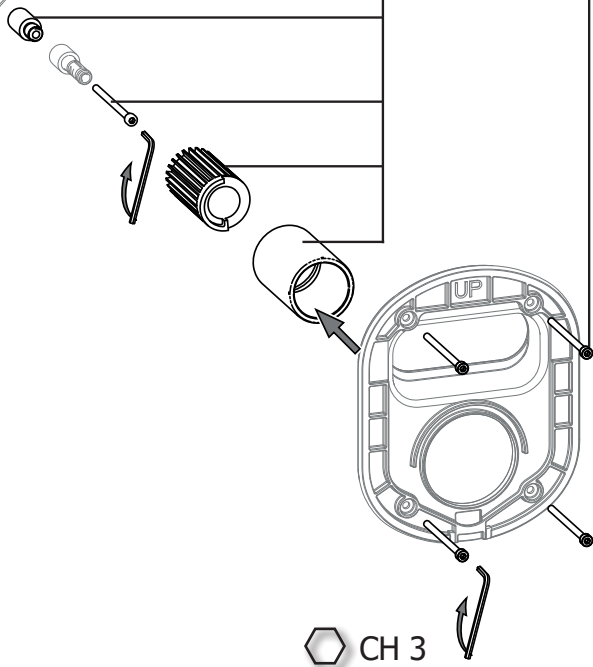

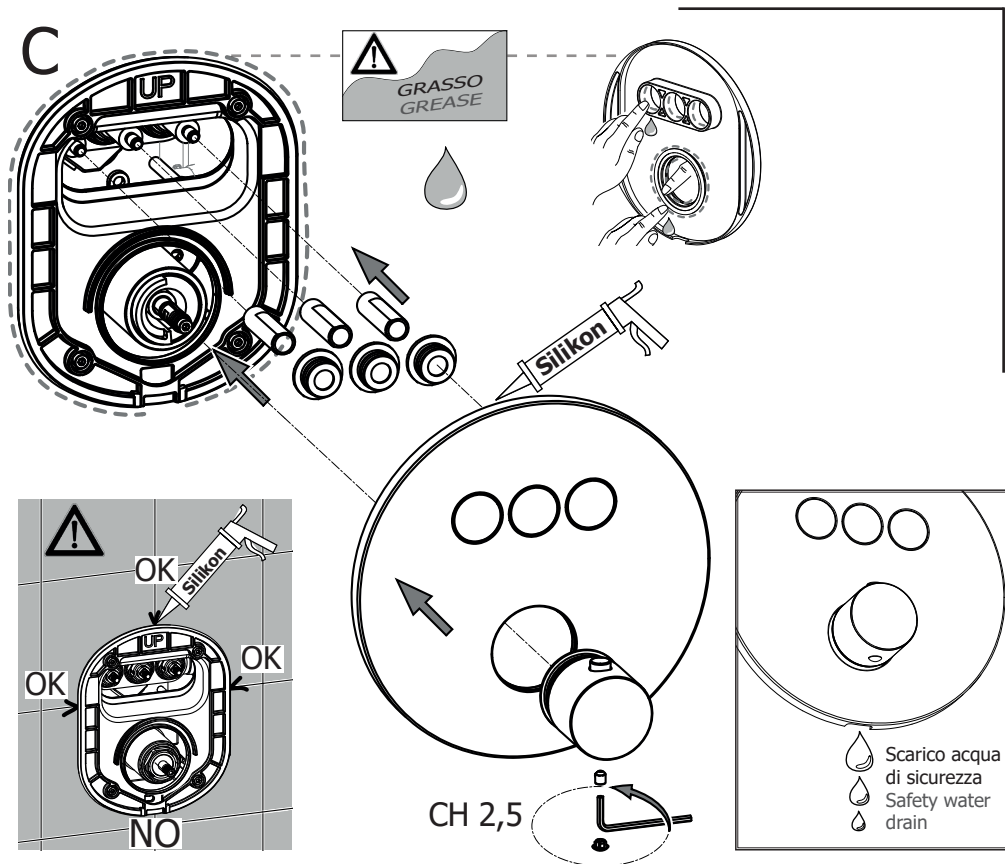

Regolazione Cartuccia Termostatica Setting Thermostatic Cartridge

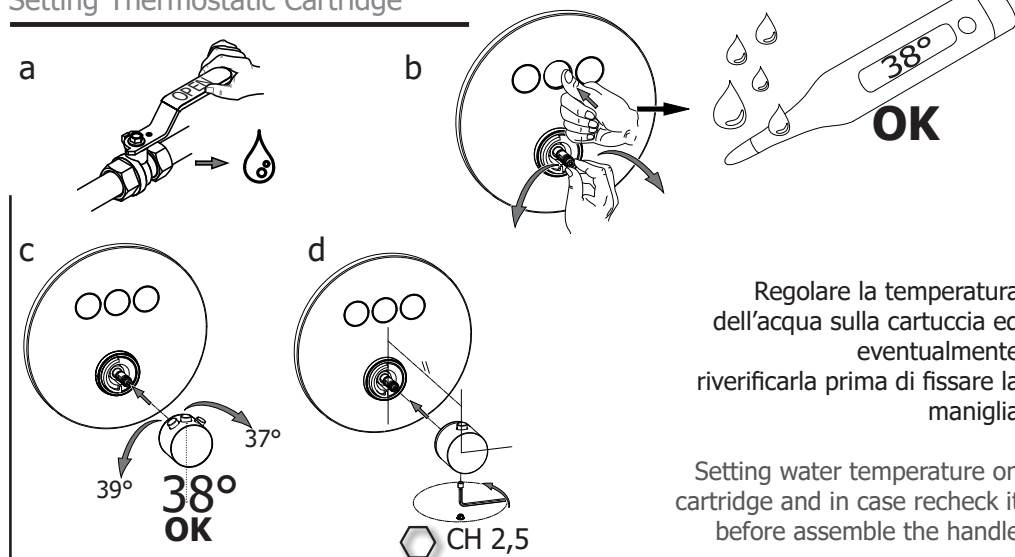


Regolare la temperatura dell'acqua sulla cartuccia ed eventualmente verificarla prima di fissare la maniglia


Setting water temperature on cartridge and in case recheck it before assemble the handle

RICAMBI SPARE PARTS


A



Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

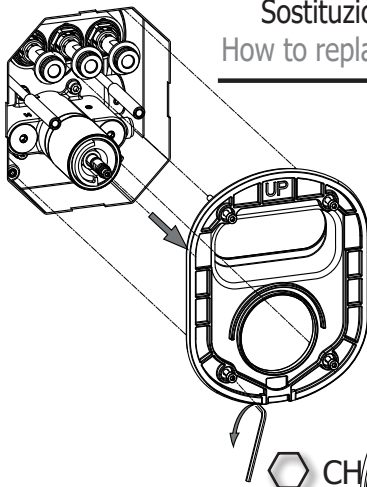

B







CH 2,5

Leggera forza di serraggio
Light torque force




Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia

Always keep the step on the CAM and ref. lines on the cartridge parallel to each other in vertical

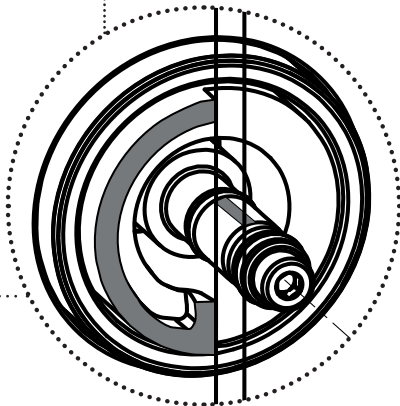



Sostituzione Cartuccia Deviatrice How to replace Diverter Cartridge

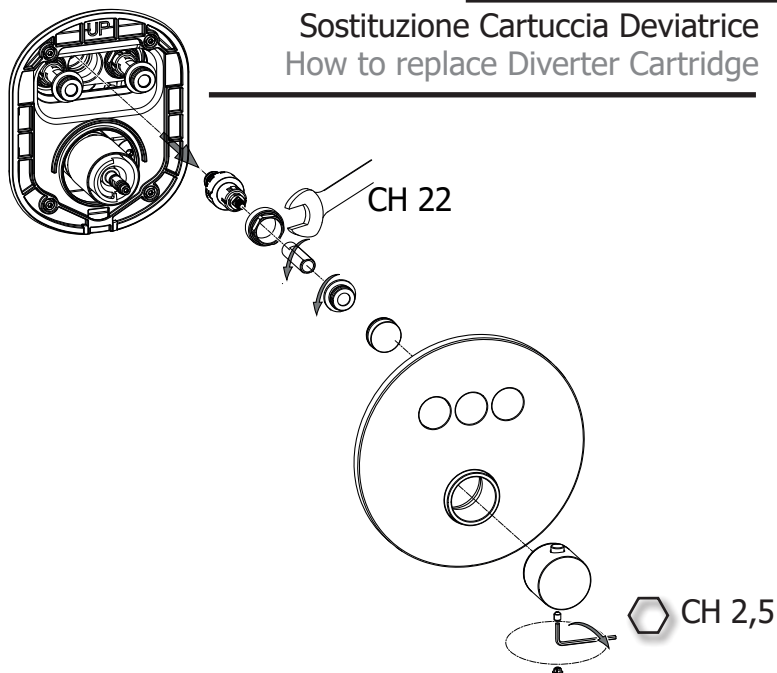


A




Sostituzione Cartuccia miscelatrice How to replace mixer Cartridge

B


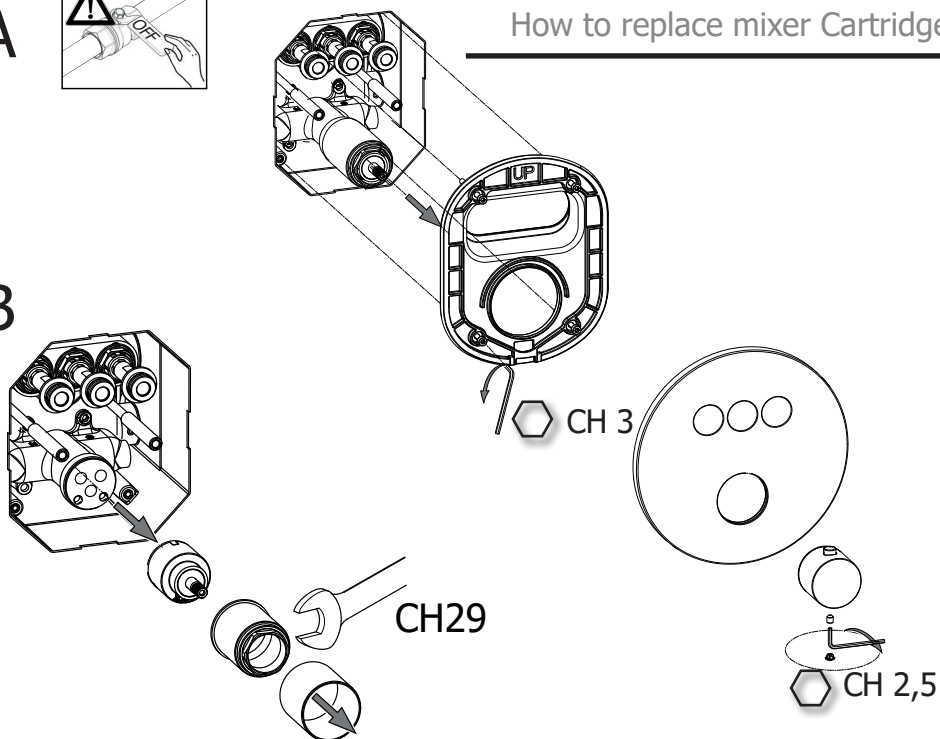


Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve


A




CH 3

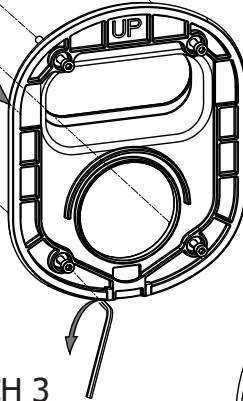


Termostatico
Thermostatics

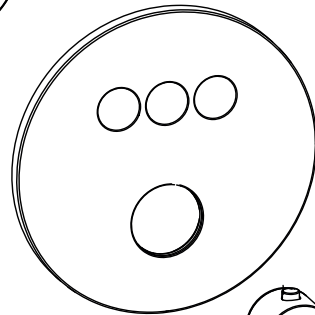

CH 2,5



B

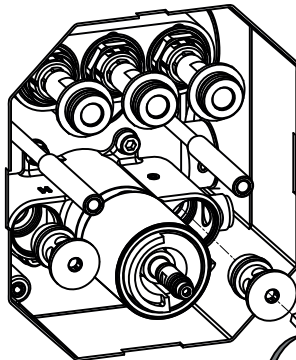


CH 8




Forza di serraggio
Torque force
10 N/m

A



Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve

Miscelatore
Mixer

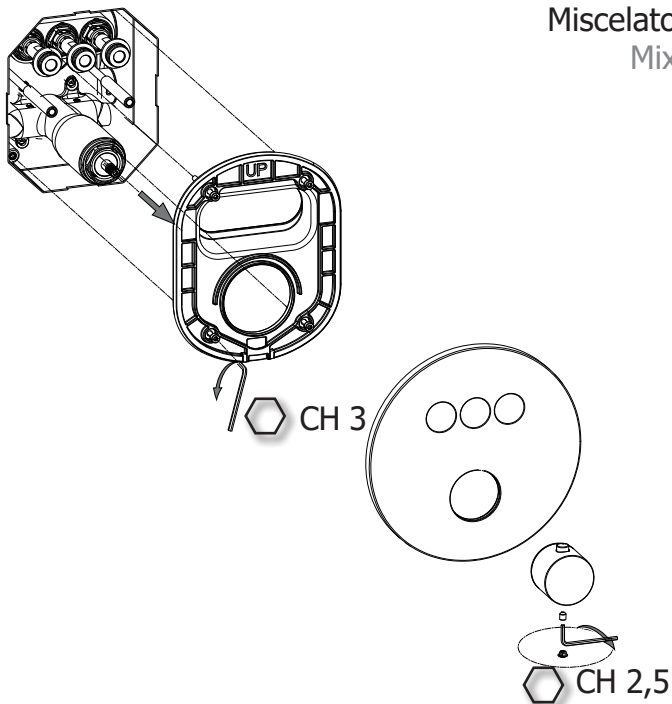

B

